

Акт градуировки ручного пенетрометра

Номер пенетрометра: 90

Индикатор ИЧ-10, зав. №: 090659

Градуировочная таблица

№ п/п	P, кг	Показания индикатора ИЧ-10, дел (мм).				q, кг/см.кв. S = 10 см.кв.	q, кг/см.кв. S = 20 см.кв.
		N1	N2	N3	Ncp		
0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	0,0
1	20	1,61	1,67	1,67	1,65	2,0	1,0
2	40	2,39	2,45	2,46	2,43	4,0	2,0
3	60	3,00	3,12	3,14	3,09	6,0	3,0
4	80	3,77	3,83	3,84	3,81	8,0	4,0
5	100	4,51	4,57	4,59	4,56	10,0	5,0
6	120	5,20	5,21	5,23	5,21	12,0	6,0
7	140	5,94	6,00	6,01	5,98	14,0	7,0
8	160	6,64	6,68	6,70	6,67	16,0	8,0

N - показания по индикатору ИЧ-10, дел (мм).


Градуировку провел: Тюлейкина
 Дата градуировки: 14.02.2011
 Заказчик: ООО "Стройбурение"

Градуировка пенетрометра № 90 выполнена: _____

(с) ЗАО "Геотест", Impeller v2.1.0.44

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист

Градуировочный график пенетromетра №90

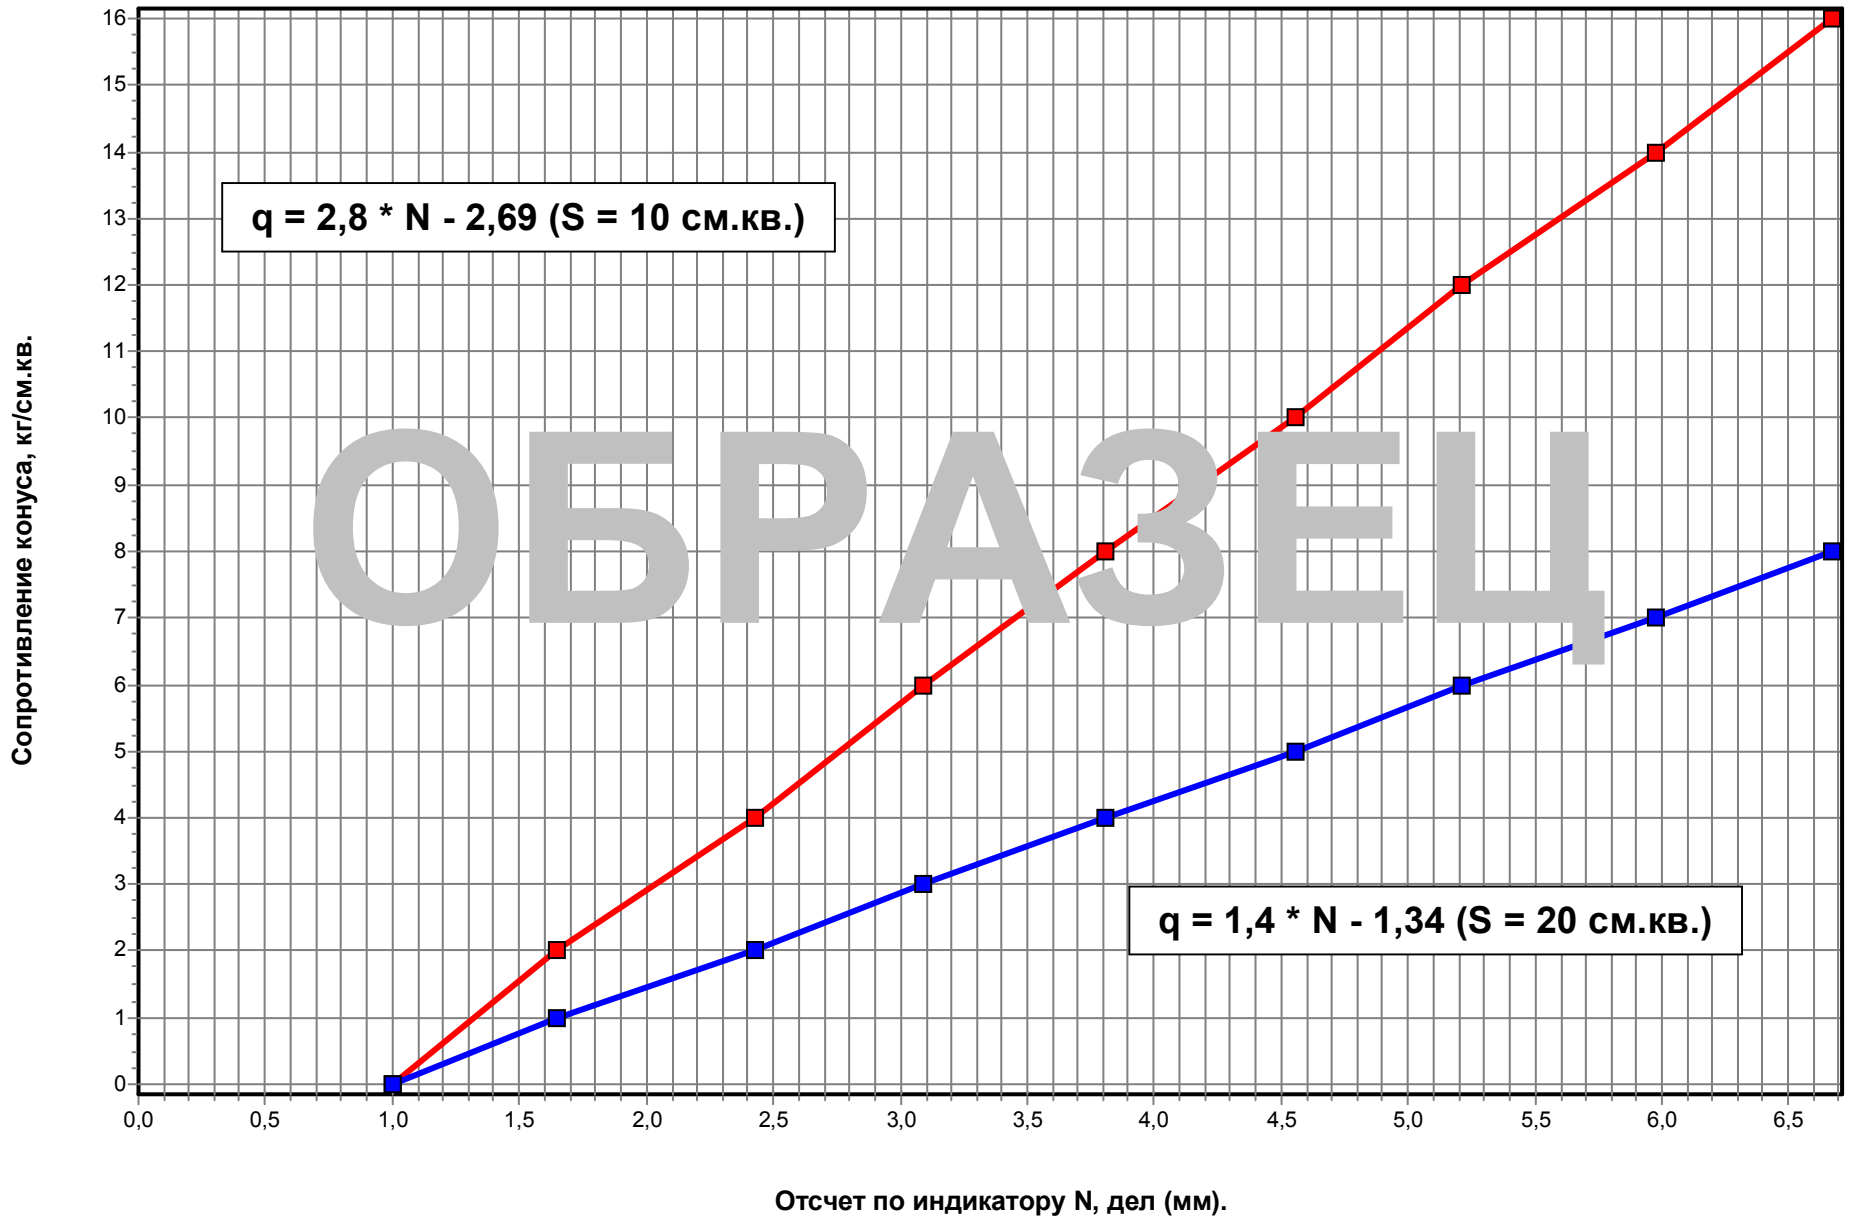

Индв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата